



บริษัท อุตสาหกรรม ขั้วพลาสติก จำกัด

RD-OPD-002/2

ที่อยู่ 30/1 หมู่ 2 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม

โทร. 034 - 249 - 929 FAX : 034 -242 - 577

ใบตรวจสอบการอบฆ่าเชื้อโรค โดยกระบวนการเอธิลีนออกไซด์

Quality Assurance Final Release Certificate For Ethylene Oxide Sterilization Processes

CERTIFICATE No. : 180804

BATCH No. : 2

วันที่/DATE : 04/08/2018

รอบที่

CUSTOMER NAME : Poli International Co.,Ltd

ผลิตภัณฑ์ / PRODUCT	จำนวน/Q'ty	Lot No.	MFD	EXP
Plastic Clamps 1's	20 Cartons	071618	05/06/18	07/2023

E.O. INDICATOR ที่บรรจุภัณฑ์ ผ่าน ไม่ผ่าน

ก่อนการฆ่าเชื้อ: / PINK หลังการฆ่าเชื้อ: /YELLOW

การตรวจสอบความปราศจากเชื้อทางชีวภาพ(E.O.BIOLOGICAL INDICATORS) ATTEST 1264

ผลการทดสอบ ระยะเวลา 48 ชั่วโมง: ผ่าน ไม่ผ่าน

GAS PRESSURE	GAS TEMPERATURE	PRODUCT TEMPERATURE	INCUBATOR TEMPERATURE	STERILE TIME	CYLINDER NO.
4.4	36	38.1	55.4	11.30	QMT-00776


ระดับความเข้มข้นของแก๊สเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการอบฆ่าเชื้อ = 0.8 ppm

หมายเหตุ: ตามมาตรฐานระดับความเข้มข้นของแก๊สต้องไม่เกิน 1 ppm.

PROCESS INDICATOR TAPES FOR ETHYLENE OXIDE (E.O.)

EO sterilization chemical indicator card

ผ่าน
 ไม่ผ่าน

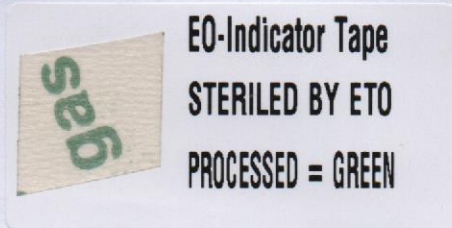

ผู้ตรวจสอบ/CHK BY :



บริษัท อุดมภัณฑ์ ซัพพลาย จำกัด

RD-OPD-002/2

ที่อยู่ 30/1 หมู่ 2 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม

โทร. 034 - 249 - 929 FAX : 034 - 242 - 577

ใบตรวจสอบการอบฆ่าเชื้อโรค โดยกระบวนการเอธิลีนออกไซด์

Quality Assurance Final Release Certificate For Ethylene Oxide Sterilization Processes

CERTIFICATE No. : 180807

BATCH No. : 4

วันที่/DATE : 07/08/2018

รอบที่

CUSTOMER NAME : Poli International Co.,Ltd

ผลิตภัณฑ์ / PRODUCT	จำนวน/Q'ty	Lot No.	MFD	EXP
Plastic Clamps 1's	20 Cartons	071618	05/06/18	07/2023

E.O. INDICATOR ที่บรรจุภัณฑ์ ผ่าน ไม่ผ่าน

ก่อนการฆ่าเชื้อ: / PINK หลังการฆ่าเชื้อ: /YELLOW

การตรวจสอบความปราศจากเชื้อทางชีวภาพ(E.O.BIOLOGICAL INDICATORS) ATTEST 1264

ผลการทดสอบ ระยะเวลา 48 ชั่วโมง: ผ่าน ไม่ผ่าน

GAS PRESSURE	GAS TEMPERATURE	PRODUCT TEMPERATURE	INCUBATOR TEMPERATURE	STERILE TIME	CYLINDER NO.
4.4	35.8	41.3	55.4	12.37	QMT-00776

ระดับความเข้มข้นของแก๊สเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการอบฆ่าเชื้อ = 0.8 ppm

หมายเหตุ: ตามมาตรฐานระดับความเข้มข้นของแก๊สต้องไม่เกิน 1 ppm.

PROCESS INDICATOR TAPES FOR ETHYLENE OXIDE (E.O.)


EO sterilization chemical indicator card



ผ่าน



ไม่ผ่าน

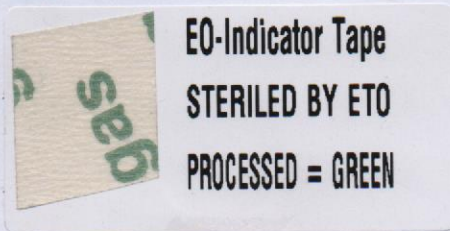

ผู้ตรวจสอบ/CHK BY :



บริษัท อุตสาหกรรม ชีพพลาย จำกัด

RD-OPD-002/2

ที่อยู่ 30/1 หมู่ 2 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม

โทร. 034 - 249 - 929 FAX : 034 -242 - 577

ใบตรวจสอบการอบฆ่าเชื้อโรค โดยกระบวนการเอทิลีนออกไซด์

Quality Assurance Final Release Certificate For Ethylene Oxide Sterilization Processes

CERTIFICATE No. : 180808

BATCH No. : 5

วันที่/DATE : 08/08/2018

รอบที่

CUSTOMER NAME : Poli International Co.,Ltd

ผลิตภัณฑ์ / PRODUCT	จำนวน/Q'ty	Lot No.	MFD	EXP
Plastic Clamps.	20 Carton	071618	05/06/18	07/2023

E.O. INDICATOR ที่บรรจุภัณฑ์ ผ่าน ไม่ผ่าน

ก่อนการฆ่าเชื้อ: / PINK หลังการฆ่าเชื้อ: /YELLOW

การตรวจสอบความปราศจากเชื้อทางชีวภาพ(E.O.BIOLOGICAL INDICATORS) ATTEST 1264

ผลการทดสอบ ระยะเวลา 48 ชั่วโมง: ผ่าน ไม่ผ่าน

GAS PRESSURE	GAS TEMPERATURE	PRODUCT TEMPERATURE	INCUBATOR TEMPERATURE	STERILE TIME	CYLINDER NO.
4.4	37.3	42.3	55.3	13.45	QMT-00776


ระดับความเข้มข้นของแก๊สเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการอบฆ่าเชื้อ = 0.8 ppm

หมายเหตุ: ตามมาตรฐานระดับความเข้มข้นของแก๊สต้องไม่เกิน 1 ppm.

PROCESS INDICATOR TAPES FOR ETHYLENE OXIDE (E.O.)

EO sterilization chemical indicator card

ผ่าน
 ไม่ผ่าน

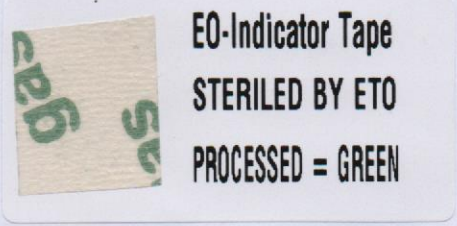

ผู้ตรวจสอบ/CHK BY :



บริษัท อุดมภัณฑ์ ซัพพลาย จำกัด

RD-OPD-002/2

ที่อยู่ 30/1 หมู่2 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม

โทร. 034 - 249 - 929 FAX : 034 -242 - 577

ใบตรวจสอบการอบฆ่าเชื้อโรค โดยกระบวนการเอทิลีนออกไซด์

Quality Assurance Final Release Certificate For Ethylene Oxide Sterilization Processes

CERTIFICATE No. : 180809

BATCH No. : 6

วันที่/DATE : 09/08/2018

รอบที่

CUSTOMER NAME : Poli International Co.,Ltd

ผลิตภัณฑ์ / PRODUCT	จำนวน/Q'ty	Lot No.	MFD	EXP
Plastic Clamps.	20 Carton	071618	05/06/18	07/2023

E.O. INDICATOR ที่บรรจุภัณฑ์ ผ่าน ไม่ผ่าน

ก่อนการฆ่าเชื้อ: / PINK หลังการฆ่าเชื้อ: /YELLOW

การตรวจสอบความปราศจากเชื้อทางชีวภาพ(E.O.BIOLOGICAL INDICATORS) ATTEST 1264

ผลการทดสอบ ระยะเวลา 48 ชั่วโมง: ผ่าน ไม่ผ่าน

GAS PRESSURE	GAS TEMPERATURE	PRODUCT TEMPERATURE	INCUBATOR TEMPERATURE	STERILE TIME	CYLINDER NO.
4.2	36.6	42.5	55.4	13.00	QMT-00776

ระดับความเข้มข้นของแก๊สเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการอบฆ่าเชื้อ = 0.8 ppm

หมายเหตุ: ตามมาตรฐานระดับความเข้มข้นของแก๊สต้องไม่เกิน 1 ppm.

PROCESS INDICATOR TAPES FOR ETHYLENE OXIDE (E.O.)


EO sterilization chemical indicator card



ผ่าน



ไม่ผ่าน

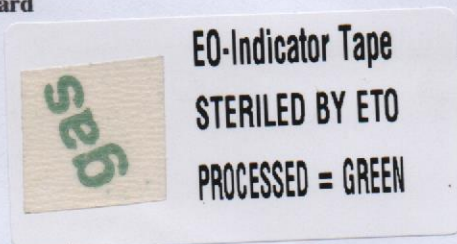

ผู้ตรวจสอบ/CHK BY :



บริษัท อุดมภัณฑ์ ชีพพลาย จำกัด

RD-OPD-002/2

ที่อยู่ 30/1 หมู่ 2 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม

โทร. 034 - 249 - 929 FAX : 034 -242 - 577

ใบตรวจสอบการอบฆ่าเชื้อโรค โดยกระบวนการเอธิลีนออกไซด์

Quality Assurance Final Release Certificate For Ethylene Oxide Sterilization Processes

CERTIFICATE No. : 180820

BATCH No. : 2

วันที่/DATE : 20/08/2018

รอบที่ 1

CUSTOMER NAME : Poli International Co., Ltd

ผลิตภัณฑ์ / PRODUCT	จำนวน/Q'ty	Lot No.	MFD	EXP
Plastic Clamps.	20 Carton	071618	05/06/18	07/2023

E.O. INDICATOR ที่บรรจุภัณฑ์ ผ่าน ไม่ผ่าน

ก่อนการฆ่าเชื้อ: / PINK หลังการฆ่าเชื้อ: /YELLOW

การตรวจสอบความปราศจากเชื้อทางชีวภาพ(E.O.BIOLOGICAL INDICATORS) ATTEST 1264

ผลการทดสอบ ระยะเวลา 48 ชั่วโมง : ผ่าน ไม่ผ่าน

GAS PRESSURE	GAS TEMPERATURE	PRODUCT TEMPERATURE	INCUBATOR TEMPERATURE	STERILE TIME	CYLINDER NO.
4.6	35.2	38.9	55	11.30	QMT - 00778

ระดับความเข้มข้นของแก๊สเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการอบฆ่าเชื้อ = 0.8 ppm


หมายเหตุ: ตามมาตรฐานระดับความเข้มข้นของแก๊สต้องไม่เกิน 1 ppm.

PROCESS INDICATOR TAPES FOR ETHYLENE OXIDE (E.O.)

EO sterilization chemical indicator card

ผ่าน

ไม่ผ่าน

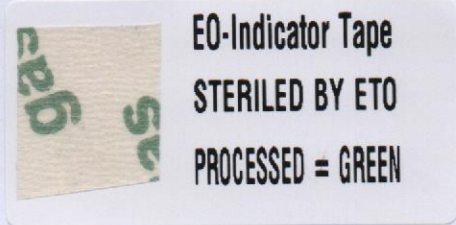

ผู้ตรวจสอบ/CHK BY :



บริษัท อุดมภัณฑ์ ซัพพลาย จำกัด

RD-OPD-002/2

ที่อยู่ 30/1 หมู่ 2 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม

โทร. 034 - 249 - 929 FAX : 034 -242 - 577

ใบตรวจสอบการอบฆ่าเชื้อโรค โดยกระบวนการเอทิลีนออกไซด์

Quality Assurance Final Release Certificate For Ethylene Oxide Sterilization Processes

CERTIFICATE No. : 180823

BATCH No. : 5

วันที่/DATE : 23/08/2018

รอบที่

CUSTOMER NAME : Poli International Co., Ltd

ผลิตภัณฑ์ / PRODUCT	จำนวน/Q'ty	Lot No.	MFD	EXP
Plastic Clamps.	20 Carton	071618	05/06/18	07/2023

E.O. INDICATOR ที่บรรจุภัณฑ์ ผ่าน ไม่ผ่าน

ก่อนการฆ่าเชื้อ: / PINK หลังการฆ่าเชื้อ: /YELLOW

การตรวจสอบความปราศจากเชื้อทางชีวภาพ(E.O.BIOLOGICAL INDICATORS) ATTEST 1264

ผลการทดสอบ ระยะเวลา 48 ชั่วโมง: ผ่าน ไม่ผ่าน

GAS PRESSURE	GAS TEMPERATURE	PRODUCT TEMPERATURE	INCUBATOR TEMPERATURE	STERILE TIME	CYLINDER NO.
4.0	36.6	36.9	54.3	12.00	QMT - 00778

ระดับความเข้มข้นของแก๊สเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการอบฆ่าเชื้อ = 0.8 ppm
หมายเหตุ: ตามมาตรฐานระดับความเข้มข้นของแก๊สต้องไม่เกิน 1 ppm.

PROCESS INDICATOR TAPES FOR ETHYLENE OXIDE (E.O.)


EO sterilization chemical indicator card



ผ่าน



ไม่ผ่าน



EO-Indicator Tape
STERILED BY ETO
PROCESSED = GREEN

ผู้ตรวจสอบ/CHK BY :



บริษัท ลุดมภัณฑ์ ซัพพลาย จำกัด

ที่อยู่ 30/1 หมู่ 2 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม

โทร. 034 - 249 - 929 FAX : 034 -242 - 577

Purchase Order To :

UDOMPHAN SUPPLY CO., LTD.

RD-OPD-002/2

ใบตรวจสอบการอบฆ่าเชื้อโรค โดยกระบวนการเอธิลีนออกไซด์

Quality Assurance Final Release Certificate For Ethylene Oxide Sterilization Processes

CERTIFICATE No. : 180926

BATCH No. : 5

วันที่/DATE : 26/09/2018

รอบที่

CUSTOMER NAME : Poli International Co., Ltd

ผลิตภัณฑ์ / PRODUCT	จำนวน/Q'ty	Lot No.	MFD	EXP
Plastic Clamps.	20 Carton	07/16/18	05/06/18	07/2023

E.O. INDICATOR ที่บรรจุภัณฑ์ ผ่าน ไม่ผ่าน

ก่อนการฆ่าเชื้อ: / PINK หลังการฆ่าเชื้อ: /YELLOW

การตรวจสอบความปราศจากเชื้อทางชีวภาพ(E.O.BIOLOGICAL INDICATORS) ATTEST 1264

ผลการทดสอบ ระยะเวลา 48 ชั่วโมง : ผ่าน ไม่ผ่าน

GAS PRESSURE	GAS TEMPERATURE	PRODUCT TEMPERATURE	INCUBATOR TEMPERATURE	STERILE TIME	CYLINDER NO.
4.1	37.2	39.4	53.8	13.30	15109TP250

ระดับความเข้มข้นของแก๊สเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการอบฆ่าเชื้อ = 0.8 ppm

หมายเหตุ: ตามมาตรฐานระดับความเข้มข้นของแก๊สต้องไม่เกิน 1 ppm.

PROCESS INDICATOR TAPES FOR ETHYLENE OXIDE (E.O.)

EO sterilization chemical indicator card



ผ่าน



ไม่ผ่าน

gas

EO-Indicator Tape
STERILED BY ETO

as

PROCESSED = GREEN

ผู้ตรวจสอบ/CHK BY :

R-1